


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Переходник KF для вакуумного шланга DN 10 — CBVAC 7155

CBVAC 7155

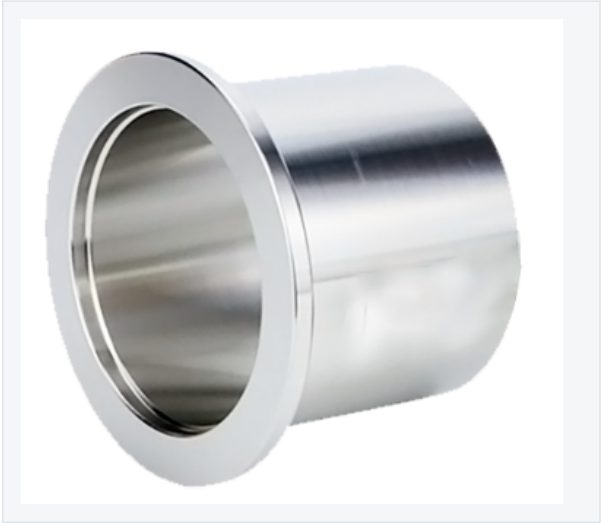

Переходник KF для вакуумного шланга CBVAC 7155: размер — DN 10; материал — Алюминиевый сплав; масса нетто — 0,04 кг; стандарт присоединения — KF; функциональная группа — Другие вакуумные компоненты; конструктивное исполнение — Переходное.

Категория	Другие вакуумные компоненты
Серия	Переходник KF для вакуумного шланга
Модель	CBVAC 7155
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7155
Размер	DN 10
Материал	Алюминиевый сплав
Масса нетто	0,04 кг
Условный проход	DN 10
Стандарт присоединения	KF
Функциональная группа	Другие вакуумные компоненты
Конструктивное исполнение	Переходное

Применение и подбор

Переходник KF для вакуумного шланга CBVAC 7155 — специализированный элемент для интеграции оборудования в вакуумную систему. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 10; стандарт присоединения — KF; материал — Алюминиевый сплав; масса нетто — 0,04 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7155 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент образует специализированный механический, измерительный или электрический интерфейс вакуумной установки. Его применимость определяется точным присоединением, геометрией, материалами и функцией в проекте.

При выборе учитывают назначение интерфейса, присоединение, материал, монтажные размеры и условия эксплуатации. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют ориентацию, доступ для подключения, разгрузку соседних деталей и безопасные расстояния. Электрические и вакуумные пределы, отсутствующие в каталожной строке, задают отдельной проектной спецификацией.

Перед установкой сверяют артикул и размеры, проверяют чистоту, целостность изоляционных и уплотнительных поверхностей. После монтажа контролируют герметичность и соответствующую функции электрическую либо механическую работоспособность. Результаты проверок сохраняют в документации установки. После разборки, изменения проводки или замены уплотнения выполняют повторный контроль интерфейса.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7155, размер DN 10, материал Алюминиевый сплав, масса нетто 0,04 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

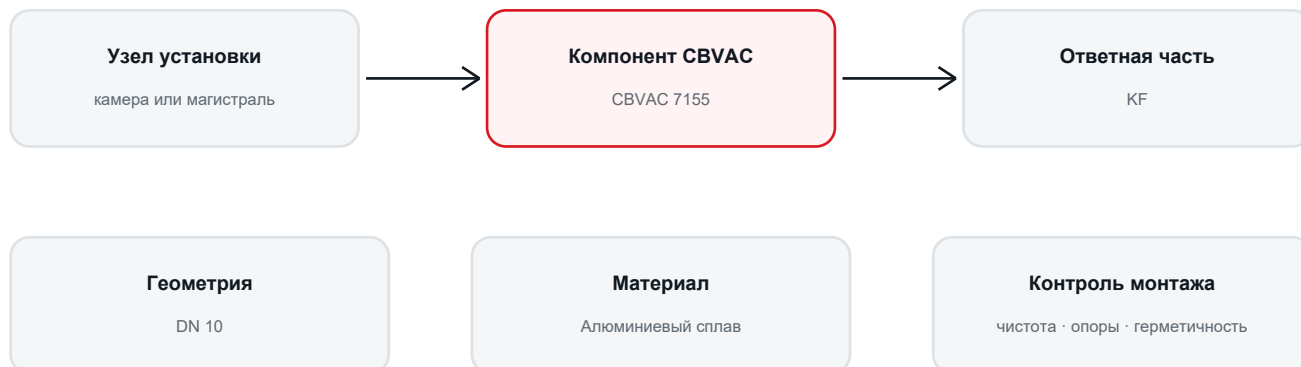

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии

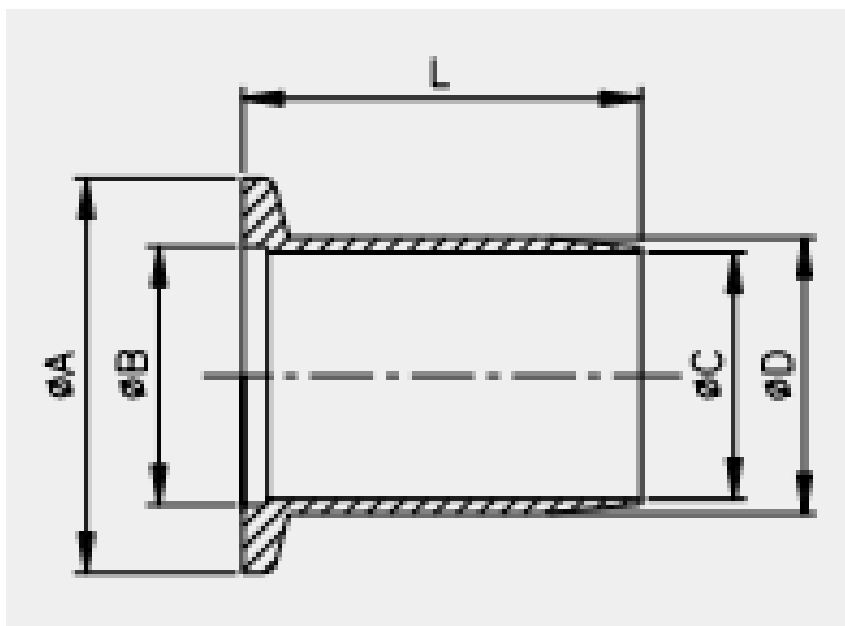

Заводская размерная схема семейства Переходник KF для вакуумного шланга; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения