

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Штампованный отвод CF DN 63, A = 105 мм — CBVAC 7418

CBVAC 7418



Штампованный отвод CF CBVAC 7418: размер — DN 63, A = 105 мм; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 2,27 кг; стандарт присоединения — CF; функциональная группа — Вакуумные отводы; конструктивное исполнение — Штампованное.

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Категория | Вакуумные отводы      |
| Серия     | Штампованный отвод CF |
| Модель    | CBVAC 7418            |
| Контакт   | info@cbvacrus.ru      |

## Технические характеристики и спецификация

| Параметр                  | Значение              |
|---------------------------|-----------------------|
| Артикул CBVAC             | 7418                  |
| Размер                    | DN 63, A = 105 мм     |
| Материал                  | Нержавеющая сталь 304 |
| Масса нетто               | 2,27 кг               |
| Условный проход           | DN 63                 |
| Размер A                  | 105 мм                |
| Стандарт присоединения    | CF                    |
| Функциональная группа     | Вакуумные отводы      |
| Конструктивное исполнение | Штампованное          |

## Применение и подбор

Штампованный отвод CF CBVAC 7418 — фасонный элемент для изменения направления вакуумной магистрали. Подтвержденные данные исполнения: размер — DN 63, A = 105 мм; стандарт присоединения — CF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 2,27 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7418 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фасонная деталь задаёт направление, разветвление или переход сечения вакуумной магистрали. Её размер и расположение влияют на компоновку и проводимость участка, поэтому изделие выбирают вместе со всей трассой, а не изолированно.

При компоновке учитывают стандарт фланцев, номинальный диаметр, монтажные размеры и проводимость участка. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют стандарты и диаметры каждого порта, ориентацию ответвлений, доступ к зажимам или болтам, опоры и отсутствие нагрузки на патрубки оборудования. Для перехода отдельно проверяют обе стороны соединения.

Перед монтажом сверяют маркировку портов, геометрию, чистоту внутренней поверхности и сохранность фланцев. Собранный участок проверяют на герметичность и отсутствие механического напряжения. При вскрытии линии защищают все порты заглушками, не допускают попадания частиц и отслеживают состояние сварных швов и уплотнительных поверхностей. Изменение трассы требует повторной проверки опор.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7418, размер DN 63, A = 105 мм, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 2,27 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


## Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

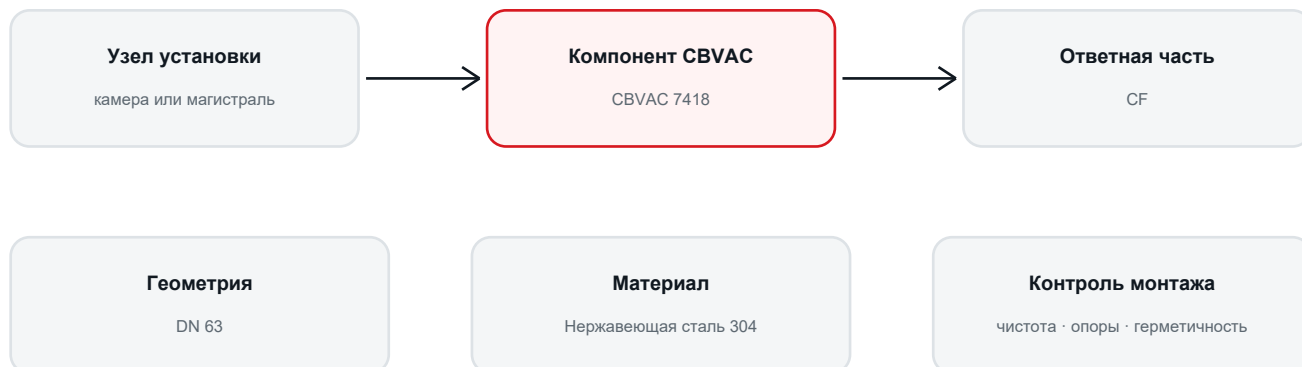

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

## Техническая схема серии

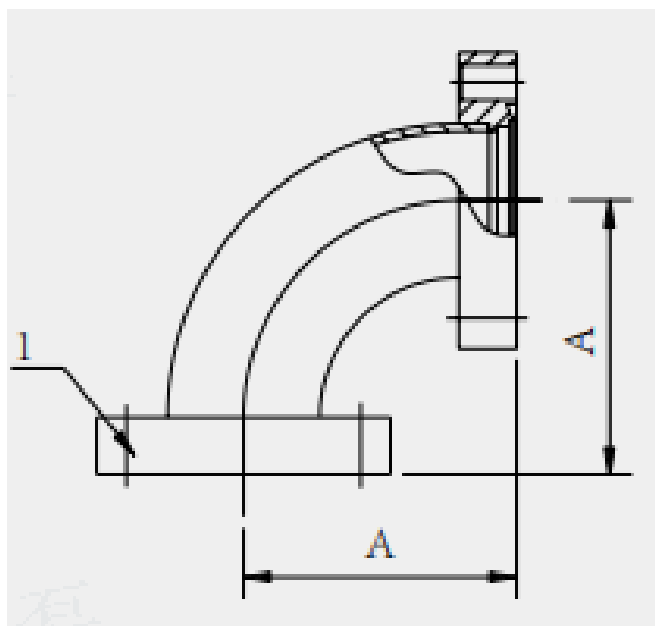

Заводская размерная схема семейства Штампованный отвод CF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения