

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Переходник ISO-K (LF) ISO-K250-ISO-K63 —  
CBVAC 7802

CBVAC 7802



Переходник ISO-K (LF) CBVAC 7802: размер — ISO-K250-ISO-K63; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 4,2 кг; стандарт присоединения — ISO-K; функциональная группа — Вакуумные переходники; конструктивное исполнение — Переходное.

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Категория | Вакуумные переходники |
| Серия     | Переходник ISO-K (LF) |
| Модель    | CBVAC 7802            |
| Контакт   | info@cbvacrus.ru      |

Технические характеристики и спецификация

| Параметр                  | Значение              |
|---------------------------|-----------------------|
| Артикул CBVAC             | 7802                  |
| Размер                    | ISO-K250-ISO-K63      |
| Материал                  | Нержавеющая сталь 304 |
| Масса нетто               | 4,2 кг                |
| Присоединение 1           | ISO-K250              |
| Присоединение 2           | ISO-K63               |
| Стандарт присоединения    | ISO-K                 |
| Функциональная группа     | Вакуумные переходники |
| Конструктивное исполнение | Переходное            |

## Применение и подбор

Переходник ISO-K (LF) CBVAC 7802 — переходной элемент для сопряжения участков вакуумной линии.

Подтверждённые данные исполнения: размер — ISO-K250-ISO-K63; стандарт присоединения — ISO-K; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 4,2 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7802 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фасонная деталь задаёт направление, разветвление или переход сечения вакуумной магистрали. Её размер и расположение влияют на компоновку и проводимость участка, поэтому изделие выбирают вместе со всей трассой, а не изолированно.

При выборе сопоставляют стандарты и диаметры обоих присоединений, длину и допустимую проводимость перехода. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют стандарты и диаметры каждого порта, ориентацию ответвлений, доступ к зажимам или болтам, опоры и отсутствие нагрузки на патрубки оборудования. Для перехода отдельно проверяют обе стороны соединения.

Перед монтажом сверяют маркировку портов, геометрию, чистоту внутренней поверхности и сохранность фланцев. Собранный участок проверяют на герметичность и отсутствие механического напряжения. При вскрытии линии защищают все порты заглушками, не допускают попадания частиц и отслеживают состояние сварных швов и уплотнительных поверхностей. Изменение трассы требует повторной проверки опор.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7802, размер ISO-K250-ISO-K63, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 4,2 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


## Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

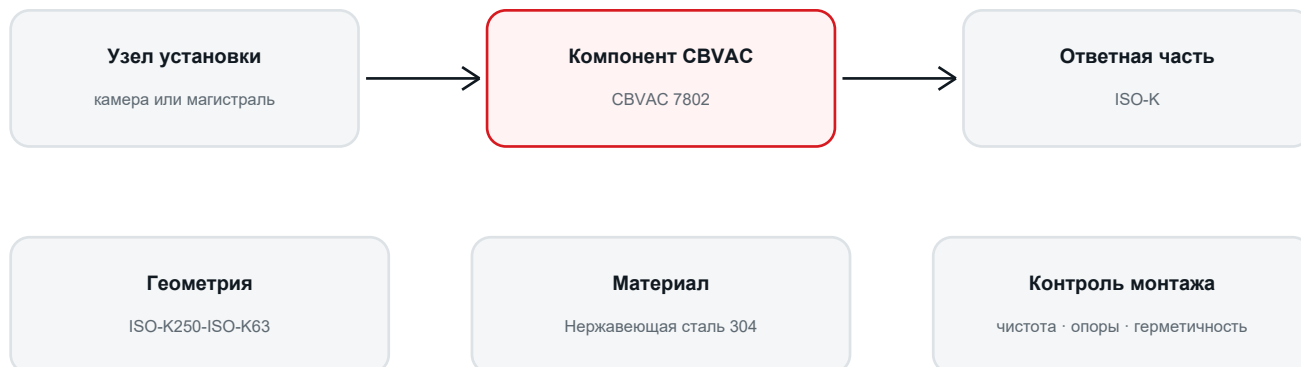

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

## Техническая схема серии

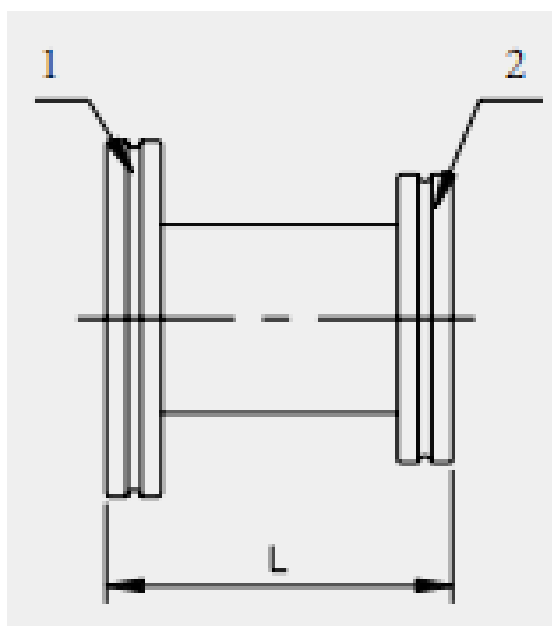

Заводская размерная схема семейства Переходник ISO-K (LF); буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения