

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Одинарный зажим ISO-K M8 — CBVAC 7820

CBVAC 7820



Одинарный зажим ISO-K CBVAC 7820: размер — M8; материал — Сталь; масса нетто — 0,15 кг; стандарт присоединения — ISO-K; функциональная группа — Зажимы и крепеж; тип крепежа — Одинарный зажим.

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Категория | Зажимы и крепеж       |
| Серия     | Одинарный зажим ISO-K |
| Модель    | CBVAC 7820            |
| Контакт   | info@cbvacrus.ru      |

Технические характеристики и спецификация

| Параметр               | Значение        |
|------------------------|-----------------|
| Артикул CBVAC          | 7820            |
| Размер                 | M8              |
| Материал               | Сталь           |
| Масса нетто            | 0,15 кг         |
| Размер резьбы          | M8              |
| Стандарт присоединения | ISO-K           |
| Функциональная группа  | Зажимы и крепеж |
| Тип крепежа            | Одинарный зажим |

## Применение и подбор

Одинарный зажим ISO-K CBVAC 7820 — крепёжный элемент разъёмного вакуумного соединения.

Подтверждённые данные исполнения: размер — M8; стандарт присоединения — ISO-K; материал — Сталь; масса нетто — 0,15 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7820 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Крепёж удерживает совместимые части разъёмного вакуумного соединения и передаёт монтажное усилие на фланцы. Сам зажим не компенсирует несовпадение стандартов, диаметра или геометрии ответных деталей.

Типоразмер и конструкцию зажима выбирают по стандарту фланцев и нагрузке собранного узла. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


Выбирают точный типоразмер, обеспечивают свободный доступ к затяжке и собирают соединение без перекоса. Нагрузку трубопровода воспринимают отдельные опоры, а не зажим.

Проверяют отсутствие трещин, деформации, повреждения резьбы и загрязнения контактных поверхностей. После первого вакуумного цикла оценивают положение соединения и отсутствие ослабления. Крепёж периодически осматривают вместе с фланцами и уплотнением. Детали с повреждённой резьбой, выраженной деформацией или нестабильной фиксацией заменяют.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7820, размер M8, материал Сталь, масса нетто 0,15 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


## Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

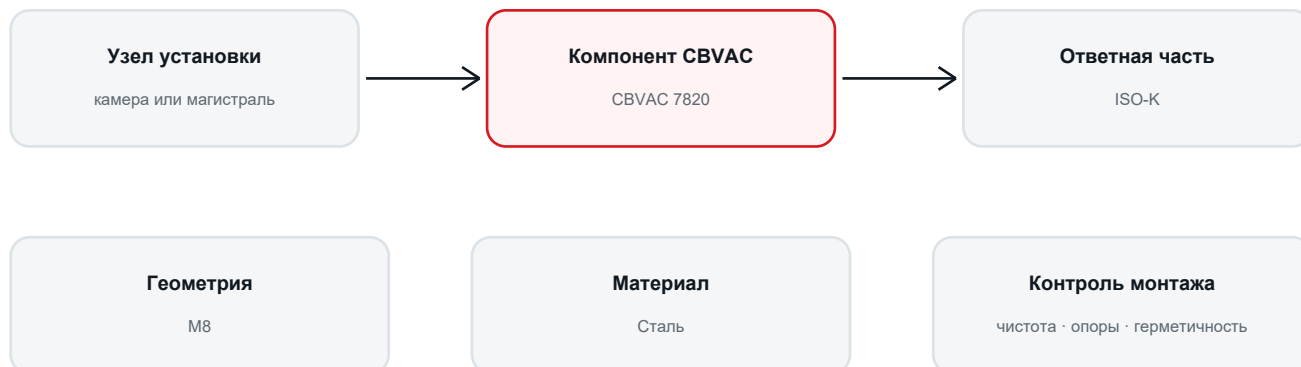

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

## Техническая схема серии

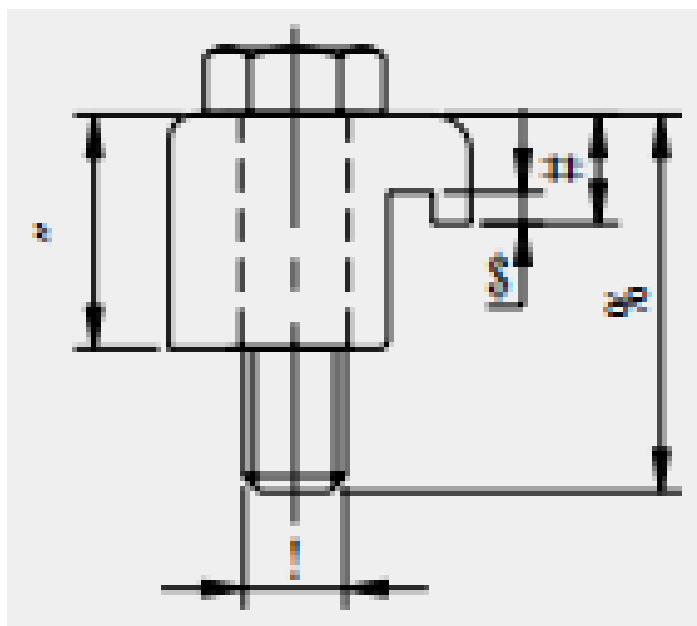

Заводская размерная схема семейства Одинарный зажим ISO-K; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения